



ese hospital san rafael yolombo <contratacionesyolombo@gmail.com>

RV: Revisión Evaluación Hospital de Yolombo

Gutierrez Martinez, Claudia Eliana <claudiaeliana.gutierrez_martinez@siemens-healthineers.com>
Para: ese hospital san rafael yolombo <contratacionesyolombo@gmail.com>
CC: "Alvarado Herrera, Celso Fernando" <celso.alvarado@siemens-healthineers.com>

17 de marzo de 2022, 17:27

Buenas tardes

Adjunto carta con observaciones

Quedamos atentos

Saludos Cordiales / Best Regards,

Claudia Eliana Gutierrez Martinez

KAM Antioquia / Choco / Eje Cafetero

No. 363
FECHA 17/03/22

FECHA	PASA A:	FIRMA
	15	



Siemens Healthcare S.A.S.
SHS AM LAM COL S-DI&AT&US
Celular: +57 3144449539

mailto:claudiaeliana.gutierrez_martinez@siemens-healthineers.com

Your organization is currently not activated for using SCMS (e-mail signatures). Please contact the IT Support or help.scf@siemens.com

Important notice: This e-mail and any attachment thereof contain corporate proprietary information. If you have received it by mistake, please notify us immediately by reply e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. Thank you.

Radicación de observaciones	de 15 al 18 de Marzo de 2022	Radicado en Centro de Gestión Documental de LA ESE o en el E Mail contratacionesyolombo@gmail.com
Acto de adjudicación y firma del contrato.	22 de Marzo de 2022	Gerencia
Inicio del contrato	22 de Marzo de 2022	

Alicia Sánchez
FECHA 17/03/22 HORA 5:27pm
ARCHIVO HOSPITAL SAN RAFAEL

17/3/22, 17:59

Gmail - RV: Revisión Evaluación Hospital de Yolombo



Carta Observaciones Licitación.pdf
955K



Siemens Healthcare S.A.S, Autopista Medellín Km. 8,5 – Costado Sur,
Tenjo, Colombia

Señores
HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ
Ciudad

Nombre	Eliana Gutierrez
Departamento	Sales Area
Teléfono	+57.1.2942400
Fax	
Mobile	+57.314 4449539
E-mail	Claudiaeliana.gutierrez_martinez@siemens-healthineers.com
Su ref.	Presentación de observaciones
Nuestra ref.	AH/EG 3859
Fecha	17/03/2022

ASUNTO: OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA 002-2022

Apreciados señores,

Por medio de la presente solicitamos revisar tres características que son habilitantes para participar en la licitación del tomógrafo del Hospital San Rafael de Yolombo de las cuales no cumple el equipo presentado por Philips Colombiana S.A.S y son las siguientes:

6.6 Capacidad total del disco duro estándar de al menos 700 GB.

De acuerdo con el nuevo datasheet aportado por el Philips, en su respuesta de la capacidad de disco no cumplen con el ítem 6.6. (Ver figura 1)

9.1 Campo de visión extendido

De acuerdo con la última ficha técnica compartida por Philips el equipo no cumple con el software de campo de visión extendido (Ver figura 1)

7. Console

Feature	Specification
Computer	Memory: ≥ 15 GB Hard disk capacity: ≥ 500 GB Ethernet connection rate: 100 Mbps
Reconstruction FOV	50 – 450 mm
Scan pitch	0.5 – 1.5
Image matrix	512 x 512, 768 x 768, 1024 x 1024
Display matrix	1024 x 1024
Image reconstruction speed	Up to 10 IPS
Image displays	1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4
Image enlargement mode	Interpolation
Range of gray level	256
Monitor	19" LCD
Monitor resolution	1280 x 1024


Figura 1

7.4 Resolución espacial o Resolución de alto contraste: 2% MTF de al menos 14.0 lp/cm
50% MTF de al menos 8 lp/cm

Teniendo en cuenta que el valor de resolución espacial expresado en lpm depende del % de MTF siendo esta una curva exponencial y el valor presentado por Philips es 15lp/cm al 0%, esto significa que el valor al 2% estará por debajo de lo solicitado es decir 14 lp/cm al 2% y 8 lp/cm al 50%. ¿Porque no se da este valor según lo solicitado por la entidad?

6. Image quality

Feature	Specification
Spatial resolution	Up to 15 ± 10% lp/cm @ 0% MTF
Low contrast resolution	3.0 mm @ 0.3% (CTDI _{vol} no more than 40 mGy, 20 cm Catphan)
Image noise	≤ 0.35%
Absorption range	-1,024 to +3,071 Hounsfield units

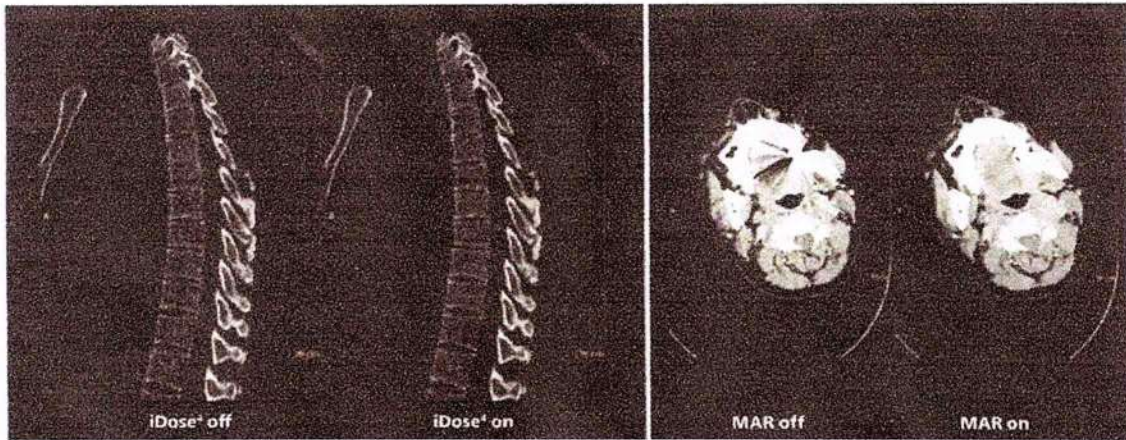

45 mAs spine imaging Preserves natural appearance at low noise and dose

Images courtesy of Nantong Oncology Hospital, Hospital of Nantong University, Jiangsu, China.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos se revise el proceso de calificación ya que no cumple con los ítems habilitantes para el mismo.

Cordialmente,

SIEMENS HEALTHCARE SAS

FABIAN RODRIGUEZ
Apoderado Especial

Electronically
signed by:
FABIAN
MAURICIO
Rodríguez
Castaneda
Reason: I am
approving this
document
Date: Mar 17,
2022 15:45 CDT

JUAN JOSE SERRANO
Representante Legal Suplente

Electronically
signed by:
JUAN JOSE
SERRANO
CAYCEDO
Reason: I have
reviewed this
document
Date: Mar 17,
2022 17:11
CDT